ОМБ СЕРВИС В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

+7 (495) 925-81-50
www.omb.ru

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор

ЭКСКЛЮЗИВ

НОВИНКА

ДЛЯ БОЛЬШИХ ЛАБОРАТОРИЙ

MACCURA® i3000

Maccura Medical Instrument Co., Ltd., Китай



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИММУНОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

200
позиций
для образцов

2 000
кювет
Единовременная
загрузка

STAT-образцы
быстрый анализ

Замена реагентов на борту
сокращение времени
исследования

Интеллектуальная система вращения пробирок
корректное считывание штрих-кода

В сегодняшних условиях нестабильности у лабораторий появилась возможность быстро адаптироваться к повседневным изменениям и получать точные результаты исследований.

Maccura® i3000 – надежное решение для высокопроизводительных лабораторий: еще больше тестов в час при двухмодульном исполнении. Анализатор использует технологию на основе акридинового эфира.



300
тестов/час

600
тестов/час
при двухмодульном исполнении



CCURA i3000

MACCURA® i3000
на www.omb.ru

1
Модуль загрузки образцов
Непрерывная дозагрузка

2
Аналитический модуль
Замена расходных материалов в режиме работы


3
Модуль хранения образцов
Хранение образцов при необходимости дальнейшего разведения

4
Зона для загрузки реакционных кювет
Внесение россыпью

5
Карусель реагентов
с поддержанием постоянной температуры 2–4 °C



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

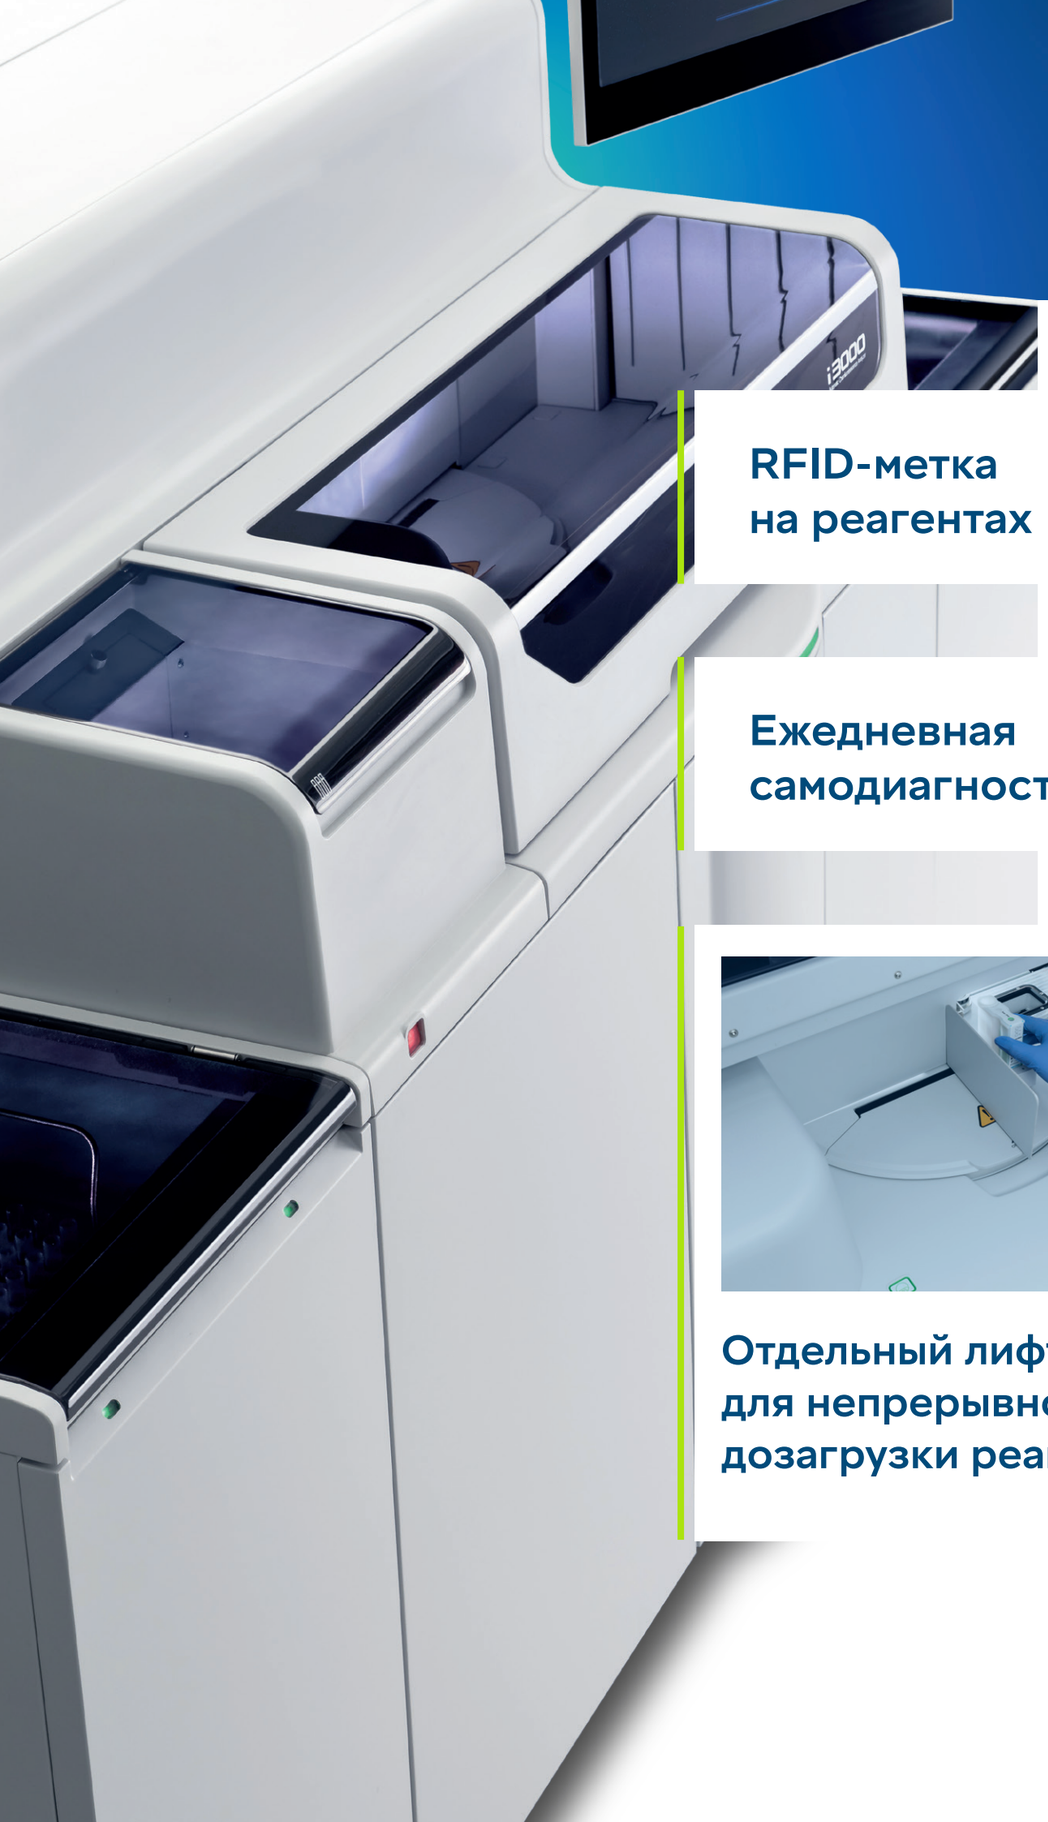

RFID-метка на реагентах

Ежедневная самодиагностика

Отдельный лифт для непрерывной дозагрузки реагентов

Хемилюминесцентный субстрат
Substrate Buffer A&B

Используется для активации метки эфира акридина, чтобы получить хемилюминесцентный сигнал.

Очищающий раствор
WS Wash Buffer

Используется для промывки и обслуживания иглы для отходов и реагентов.

Реакционные кюветы
Reaction Cuvettes

Используются для проведения иммунной реакции, разведения, промывки.

Промывающий раствор
CLIA Wash buffer

Используется для промывки системы в процессе исследований и для разведения образцов, при необходимости.





МЕНЮ ТЕСТОВ

Щитовидная железа

- **ТТГ**
- **Т3 общий**
- **Т4 общий**
- **Т3 свободный**
- **Т4 свободный**
- **Анти-ТГ**
- **Анти-ТПО**
- Анти-рТТГ — в процессе получения РУ
- Тиреоглобулин (ТГ)
- Т3 реверсивный

Аллергия

- IgE — в процессе получения РУ

Костный метаболизм

- **25-ОН Витамин Д**
- **Кальцитонин**
- Паратиреоидный гормон интактный — в процессе получения РУ
- P1NP (общий N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)
- Остеокальцин

Надпочечники

- **Гормон роста GH**
- IGFBP-3 — в процессе получения РУ

Онкомаркеры

- **АФП**
- **РЭА**
- **ПСА общий**
- **ПСА свободный**
- **CA 19-9**
- **CA 125**
- **CA 15-3**
- **CA 72-4**
- **HE4**
- **NSE**
- CA 50
- CA 242
- CYFRA 21-1
- ProGRP
- SCC
- S-100
- PIVKA-II
- Гастрин-17
- Пепсиноген I
- Пепсиноген II

Маркеры воспаления

- **Прокальцитонин**
- **IL-6**
- SAA

Инфекции

- **HBsAg**
- **Anti-HCV**
- **Anti-TP**
- **HIV Ag/Ab**
- HBsAb — в процессе получения РУ
- HBeAg
- HBeAb
- HBcAb
- HEV-IgM
- HEV-IgG
- HAV IgM
- HBV Pre S1
- Anti-HBc IgM

Репродуктивная система

- **АМГ**
- **Общий бета-ХГЧ**
- **ФСГ**
- **ЛГ**
- **Пролактин**
- **Эстрадиол**
- **Прогестерон**
- **Тестостерон**
- **DHEA-S**

Аутоиммунный профиль

- Anti-CENP-B
- Anti-His
- Anti-Rib-P
- Anti-Scl-70
- Anti-SSA (Ro52)
- Anti-dsDNA
- Anti-PCNA
- Anti-PM-Scl
- Anti-AMA-M2
- Anti-Nuc
- Anti-Jo-1
- Anti-SSB (La)
- Anti-SSA (Ro60)
- Anti-Sm
- Anti-Sm/RNP
- aCL-P
- aCL-A
- aCL-G
- aCL-M
- β2-GP1-P
- β2-GP1-A
- β2-GP1-M
- β2-GP1-G
- Anti-MPO
- Anti-PR3
- Anti-GBM
- Anti-gp210
- Anti-sp100
- Anti-LKM-1
- Anti-LC-1
- Anti-SLA/LP

Сахарный диабет

- **С-пептид**
- **Инсулин**
- IGF-1 — в процессе получения РУ

TORCH

- TOXO IgG — в процессе получения РУ
- TOXO IgM — в процессе получения РУ
- HSV 2 IgG — в процессе получения РУ
- HSV 1 IgG — в процессе получения РУ
- HSV 2 IgM — в процессе получения РУ
- HSV 1 IgM — в процессе получения РУ
- Rubella IgG — в процессе получения РУ
- Rubella IgM — в процессе получения РУ
- CMV IgG — в процессе получения РУ
- CMV IgM — в процессе получения РУ

Ревматоидная панель

- RF — в процессе получения РУ
- Anti-CCP — в процессе получения РУ
- RF-IgG
- RF-IgA
- RF-IgM

Гипертензия

- **Альдостерон**
- **АКТГ**
- **Прямой ренин**
- **Кортизол**

Пренатальный скрининг

- Свободный β-HCG
- PAPP-A
- uE3

Сердечно-сосудистая система

- **CK-MB**
- **Миоглобин**
- **NT-proBNP (N-терминальный натрийуретический пропептид b-типа)**
- **Д-димер**
- **Высокочувствительный тропонин (hs-cTnI)**
- **Высокочувствительный тропонин (hs-cTnT)**
- Тропонин I
- BNP (общий N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)
- GDF-15
- Биомаркер ST2
- Высокочувствительный CRP

Анемия

- **Витамин B12**
- **Ферритин**
- **Фолиевая кислота**

Другие аналиты

- NfL
- GFAP
- CP-IgG
- CP-IgM
- MP-IgM
- MP-IgG

Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2024/22105 от 22.02.2024
Анализатор хемилюминесцентный автоматический Maccura i варианты исполнения:
I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000
II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000

* Тесты, выделенные жирным шрифтом, зарегистрированы в качестве медицинских изделий Росздравнадзором (регистрационные номера медицинских изделий: РЗН 2024/22519, РЗН 2024/22518, РЗН 2024/22553, РЗН 2024/22575, РЗН 2024/22046, РЗН 2024/22517, РЗН 2024/22233, РЗН 2024/22552, РЗН 2024/21998, РЗН 2024/22000, РЗН 2024/22010, РЗН 2024/22534, РЗН 2024/22546, РЗН 2024/22009, РЗН 2024/22229, РЗН 2024/22054, РЗН 2024/22053, РЗН 2024/22560, РЗН 2024/22119, РЗН 2024/22055, РЗН 2024/21995, РЗН 2024/22047, РЗН 2024/22262, РЗН 2024/21992, РЗН 2024/22230, РЗН 2024/22255, РЗН 2024/22574, РЗН 2024/22022, РЗН 2024/22254, РЗН 2024/22520, РЗН 2024/22098, РЗН 2024/22278, РЗН 2024/22242, РЗН 2024/22276, РЗН 2024/22241, Г004-00110-00/03809562, Г004-00110-00/03656478, Г004-00110-00/03809645, Г004-00110-00/03876548, Г004-00110-00/04214280, Г004-00110-00/04172997, Г004-00110-00/03992424, Г004-00110-00/03841870, Г004-00110-00/03992510, Г004-00110-00/04059276, Г004-00110-00/03985232, Г004-00110-00/03958956, Г004-00110-00/04202755, Г004-00110-00/04402685, Г004-00110-00/04457787, Г004-00110-00/04437102, Г004-00110-00/04458016, Г004-00110-00/04350801, Г004-00110-00/04275944, Г004-00110-00/04750434, Г004-00110-00/04684442, Г004-00110-00/04683550, Г004-00110-00/04548446, Г004-00110-00/04773354, Г004-00110-00/04716928, Г004-00110-00/04654402, Г004-00110-00/04059276, Г004-00110-00/04458016), остальные — в процессе регистрации.

Информация о зарегистрированных тестах приведена с учетом полученных документов на 01.09.2026 г.

Актуальная информация о зарегистрированных тестах содержится на сайте Росздравнадзора: https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch

ОМБ СЕРВИС В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

+7 (495) 925-81-50
omb@omb.ru
zakaz@omb.ru

Больше на www.omb.ru